


Isothermes d'Andrews

T °C	26,8	31	36	T °C	42,6
V (mL)	p (bar)	p (bar)	p (bar)	V(mL)	p(bar)
0,36	40			0,425	40
0,36	45			0,4	44,5
0,375	35	44,5		0,41	43
0,38	30	43,5		0,415	41,5
0,4	27	33,9	40	0,44	38,5
0,5	25,2	27,5	30,6	0,445	37,5
0,75	25,2	27,4	30,6	0,465	36
1	25,1	27,3	30,6	0,9	35
1,25	25	27,3	30,4	1,23	34
1,5	24,8	27,2	29,8	1,48	32
1,75	24,8	26,8	28	1,75	29,5
2	24,2	25	26,2	1,95	28
2,25	22,9	23,55	24,5	2,22	25,5
2,5	21,45	22,2	22,9	2,49	24
2,75	20,25	20,9	21,5	2,63	23
3	19,1	19,7	20,2	2,8	22
3,25	18	18,5	19,1	3,17	20,25
3,5	17	17,5	18	3,62	18,25
3,75	16,1	16,6	17	3,9	17
4	15,3	15,7	16,1	4	16,7



T °C	26,8	31	36	T °C	42,6
V (mL)	pV (dJ)	pV (dJ)	pV (dJ)	V(mL)	pV (dJ)
0,36	14,4			0,425	17
0,36	16,2			0,4	17,8
0,375	13,125	16,6875		0,41	17,63
0,38	11,4	16,53		0,415	17,2225
0,4	10,8	13,56	16	0,44	16,94
0,5	12,6	13,75	15,3	0,445	16,6875
0,75	18,9	20,55	22,95	0,465	16,74
1	25,1	27,3	30,6	0,9	31,5
1,25	31,25	34,125	38	1,23	41,82
1,5	37,2	40,8	44,7	1,48	47,36
1,75	43,4	46,9	49	1,75	51,625
2	48,4	50	52,4	1,95	54,6
2,25	51,525	52,9875	55,125	2,22	56,61
2,5	53,625	55,5	57,25	2,49	59,76
2,75	55,6875	57,475	59,125	2,63	60,49
3	57,3	59,1	60,6	2,8	61,6
3,25	58,5	60,125	62,075	3,17	64,1925
3,5	59,5	61,25	63	3,62	66,065
3,75	60,375	62,25	63,75	3,9	66,3
4	61,2	62,8	64,4	4	66,8

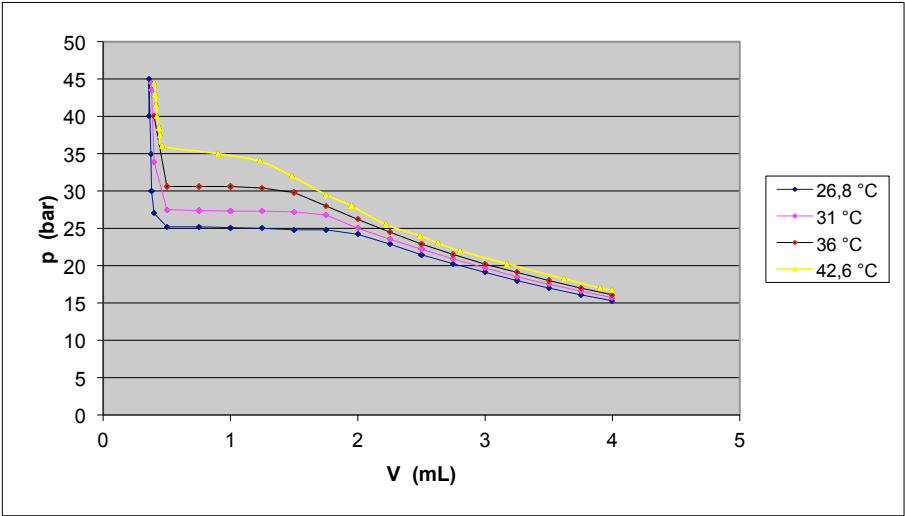